

 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	CERTIFICACIÓN	CÓDIGO GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025
		Página: 1 de 4

CERT-026-26

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

CERTIFICA:

Que una vez verificado el Plan anual de Adquisiciones para el año 2026 del Hospital San Vicente de Arauca ESE, aprobado mediante Resolución No. 2.0693 del 30 de diciembre de 2025. modificado mediante la Resolución 2.0089 del 18 de febrero del 2026. Se certifica que se encuentra incluida la necesidad de llevar a cabo. **ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Realizando Verificación de precios contenidos en el estudio de mercado se certifica su precio con el fin de realizar la compra hasta por un valor **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA.**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CODIGO Y RUBRO DE GASTO: 2.4.5.01.04.01-4815009 - RECURSO: 01 - CONCEPTO: PARTES Y ACCESORIOS PARA MATERIAL ELECTROMEDICO
CODIGO UNSPSC 42272500;42192401;42192404;42192210;42201500

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION	VALOR PAA 2026 CON IVA INCLUIDO
1	LATIGUILLOS PARA ECG DE 3 DERIVACIONES, MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN	UNIDAD	\$ 181.958,82
2	LATIGUILLOS PARA ECG DE 5 DERIVACIONES, MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN	UNIDAD	\$ 181.958,82
3	INTERFAZ DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN PARA ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL	UNIDAD	\$ 221.963,96
4	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN ADULTO	UNIDAD	\$ 222.369,86
5	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN NEONATAL	UNIDAD	\$ 247.703,55
6	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 272.417,33
7	PULSIOXIMETROS PARA MONITOR DRAGGER Y EDAN, 6 PINES DE CONEXIÓN	UNIDAD	\$ 824.738,37
8	BRAZALETE NIBP ADULTO	UNIDAD	\$ 84.022,53
9	BRAZALETES NIBP NEONATALES	UNIDAD	\$ 61.109,48
10	BRAZALETES NIBP PEDIATRICOS	UNIDAD	\$ 61.458,80
11	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 00	UNIDAD	\$ 620.996,25
12	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 0	UNIDAD	\$ 620.996,25
13	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 1	UNIDAD	\$ 620.996,25
14	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 2	UNIDAD	\$ 620.996,25

Siempre pensando en tu salud y bienestar



Hospital
**San Vicente
de Arauca**
E.S.E.
NIT 800.218.979-4

CERTIFICACIÓN

CÓDIGO GD-AR-FR-28

VERSIÓN: 01

FECHA: 29/12/2025

Página: 2 de 4

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION	VALOR PAA 2026 CON IVA INCLUIDO
15	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 3	UNIDAD	\$ 620.996,25
16	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN RECTA NO. 4	UNIDAD	\$ 620.996,25
17	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 00	UNIDAD	\$ 620.996,25
18	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 0	UNIDAD	\$ 620.996,25
19	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 1	UNIDAD	\$ 620.996,25
20	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 2	UNIDAD	\$ 620.996,25
21	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 3	UNIDAD	\$ 620.996,25
22	HOJA PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN CURVA NO. 4	UNIDAD	\$ 620.996,25
23	BATERIAS PARA MONITORES DRAGGER: VOLTAJE: 14,8 - CAPACIDAD 2500/37WH - LIMITE DE CARGA 16,8V	UNIDAD	\$ 1.269.759,75
24	BOMBILLO PARA LAMPARA CIELITICA (HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP) 50W - 12V	UNIDAD	\$ 67.808,67
25	CABLE ECG 5 LEADS PARA MONITOR MINDRAY IMEC	UNIDAD	\$ 433.525,19
26	CABLE ECG 3 LEADS PARA MONITOR MINDRAY IMEC	UNIDAD	\$ 433.525,19
27	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES MINDRAY, 12 PINES DE CONEXIÓN PARA NEONATAL	UNIDAD	\$ 473.225,28
28	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES MINDRAY, 12 PINES DE CONEXIÓN PARA ADULTO	UNIDAD	\$ 468.454,55
29	SENSOR DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES MINDRAY, 12 PINES DE CONEXIÓN PARA PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 473.281,25
30	INTERFAZ DE PULSIOXIMETRIA PARA MONITORES MINDRAY, 12 PINES DE CONEXIÓN	UNIDAD	\$ 284.183,51
31	BATERIA PARA MONITOR MINDRAY DC 10,95V ==2500MAH== 27,38WH	UNIDAD	\$ 983.212,80
32	ELECTRODOS DE EXTREMIDADES X4 PINZAS ADULTO	CAJA X4	\$ 194.418,72
33	ELECTRODOS DE SUCCION ADULTO BANANA	CAJA X6	\$ 158.844,05
34	PAPEL DE IMPRESIÓN PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC-5631 50*20MM	UNIDAD	\$ 75.999,86
35	BATERIA PARA VENTILADORES PORTATILES MARCA ZOLL	UNIDAD	\$ 8.667.918,86
36	KIT FONENDOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III	UNIDAD	\$ 132.006,68
37	CABLES PARA EQUIPOS DE ORGANOS	UNIDAD	\$ 1.797.438,00
38	PORTA BOMBILLO PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN	UNIDAD	\$ 423.178,43
39	SENSORES DE FLUJO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DRÄGER PRIMUS	UNIDAD	\$ 1.912.267,47
40	SENSORES DE FLUJO VENTILADORES VELA CAREFUSION	UNIDAD	\$ 2.078.700,00
41	BOMBILLO PARA HOJAS DE LARINGOSCOPIO COMPATIBLE CON TAMAÑOS 0-1	UNIDAD	\$ 118.244,21

Siempre pensando en tu salud y bienestar



Hospital
**San Vicente
de Arauca**
E.S.E.
NIT 800.218.979-4

CERTIFICACIÓN

CÓDIGO GD-AR-FR-28


VERSIÓN: 01

FECHA: 29/12/2025

Página: 3 de 4

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION	VALOR PAA 2026 CON IVA INCLUIDO
42	BOMBILLO PARA HOJAS DE LARINGOSCOPIO COMPATIBLE CON TAMAÑOS 2-3-4	UNIDAD	\$ 117.208,55
43	MANGUERA DE NIBP ENTRADA MINDRAY IMEC	UNIDAD	\$ 250.945,22
44	RUEDAS PARA CAMA HOSPITALARIA	UNIDAD	\$ 275.713,73
45	CONTROLES PARA CAMA HOSPITALARIA: LOS PINOS, DOMETAL, PARAMOUNT BED	UNIDAD	\$ 1.073.028,02
46	REGULADOR PARA CILINDROS GRANDES	UNIDAD	\$ 341.503,97
47	REGULADOR CLICK CGA 870 0-15 LPM, DISS, MCARE CON CONEXIÓN A HUMIDIFICADOR PERILLA REGULADORA DE OXIGENO - TIPO CLICK PARA FLUJOS DE 0-15 LPM 0 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 LPM	UNIDAD	\$ 329.955,50
48	OTOSCOPIO HALOGENO (SOLO CABEZA) 3.5V CON 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO	UNIDAD	\$ 1.634.840,36
49	OTOSCOPIO LUZ (SOLO CABEZA) 3.5V CON 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO	UNIDAD	\$ 1.464.488,43
50	OFTALMOSCOPIO LUZ (SOLO CABEZA) 3.5V CON 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO	UNIDAD	\$ 2.196.113,96
51	CELDA DE OXIGENO, VENTILADOR MECANICO NEUMOVENT CLASS R - 17 MED	UNIDAD	\$ 717.213,00
52	FLUJOMETRO DOBLE + ACOUPLE	UNIDAD	\$ 4.088.527,84
53	REGULADOR DE YUGO O MANÓMETRO	UNIDAD	\$ 2.503.551,51
54	MANÓMETRO DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	\$ 2.593.603,58
55	REGULADOR TIPO CLIC PARA BALAS DE OXIGENO DE 1M3	UNIDAD	\$ 3.329.538,60
56	ORING O EMPAQUE PARA REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD	\$ 49.833,33
57	SOCKET O PORTA BOMBILLO REF. 608125-501 PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA REF: 60813, 60814, 60815	UNIDAD	\$ 829.269,94
58	BOMBILLO REF. 04800 PARA HOJAS DE LARINGOSCOPIO ESTÁNDAR REF: 634 NO.2-4 , REF: 640 NO.1-2-4 , REF: 664 NO.2-4 , REF: 674 NO.2-4 , REF: 684 NO.2-4 , REF: 694 NO.3-4 Y TRANSLUMINADOR REF: 40415	UNIDAD	\$ 829.269,94
59	KIT DE REPUESTO PARA FONENDOSCOPIO MARCA: LITTMAN MODELO: CLASSIC II (INCLUYE OLIVAS, DIAFRAGMA ADULTO, DIAFRAGMA PEDIATRICO, ARO DE CAMPANA)	UNIDAD	\$ 431.220,37
60	SENSORES DE PIEL PARA SERVO CUNA NINGO DAVID HKN93B	UNIDAD	\$ 384.867,00
61	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER MODELO PRIMUS	UNIDAD	\$ 1.326.831,90
62	BATERIAS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS	UNIDAD	\$ 1.492.685,88
63	CASCADA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	\$ 3.405.143,81
64	SOPORTE CASCADA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	\$ 3.104.333,33
65	VALVULA EXPIRATORIA HAMILTON (REUTILIZABLE)	UNIDAD	\$ 2.935.468,80
66	VALVULA EXPIRATORIA DRAGER (REUTILIZABLE)	UNIDAD	\$ 1.908.054,72

Siempre pensando en tu salud y bienestar

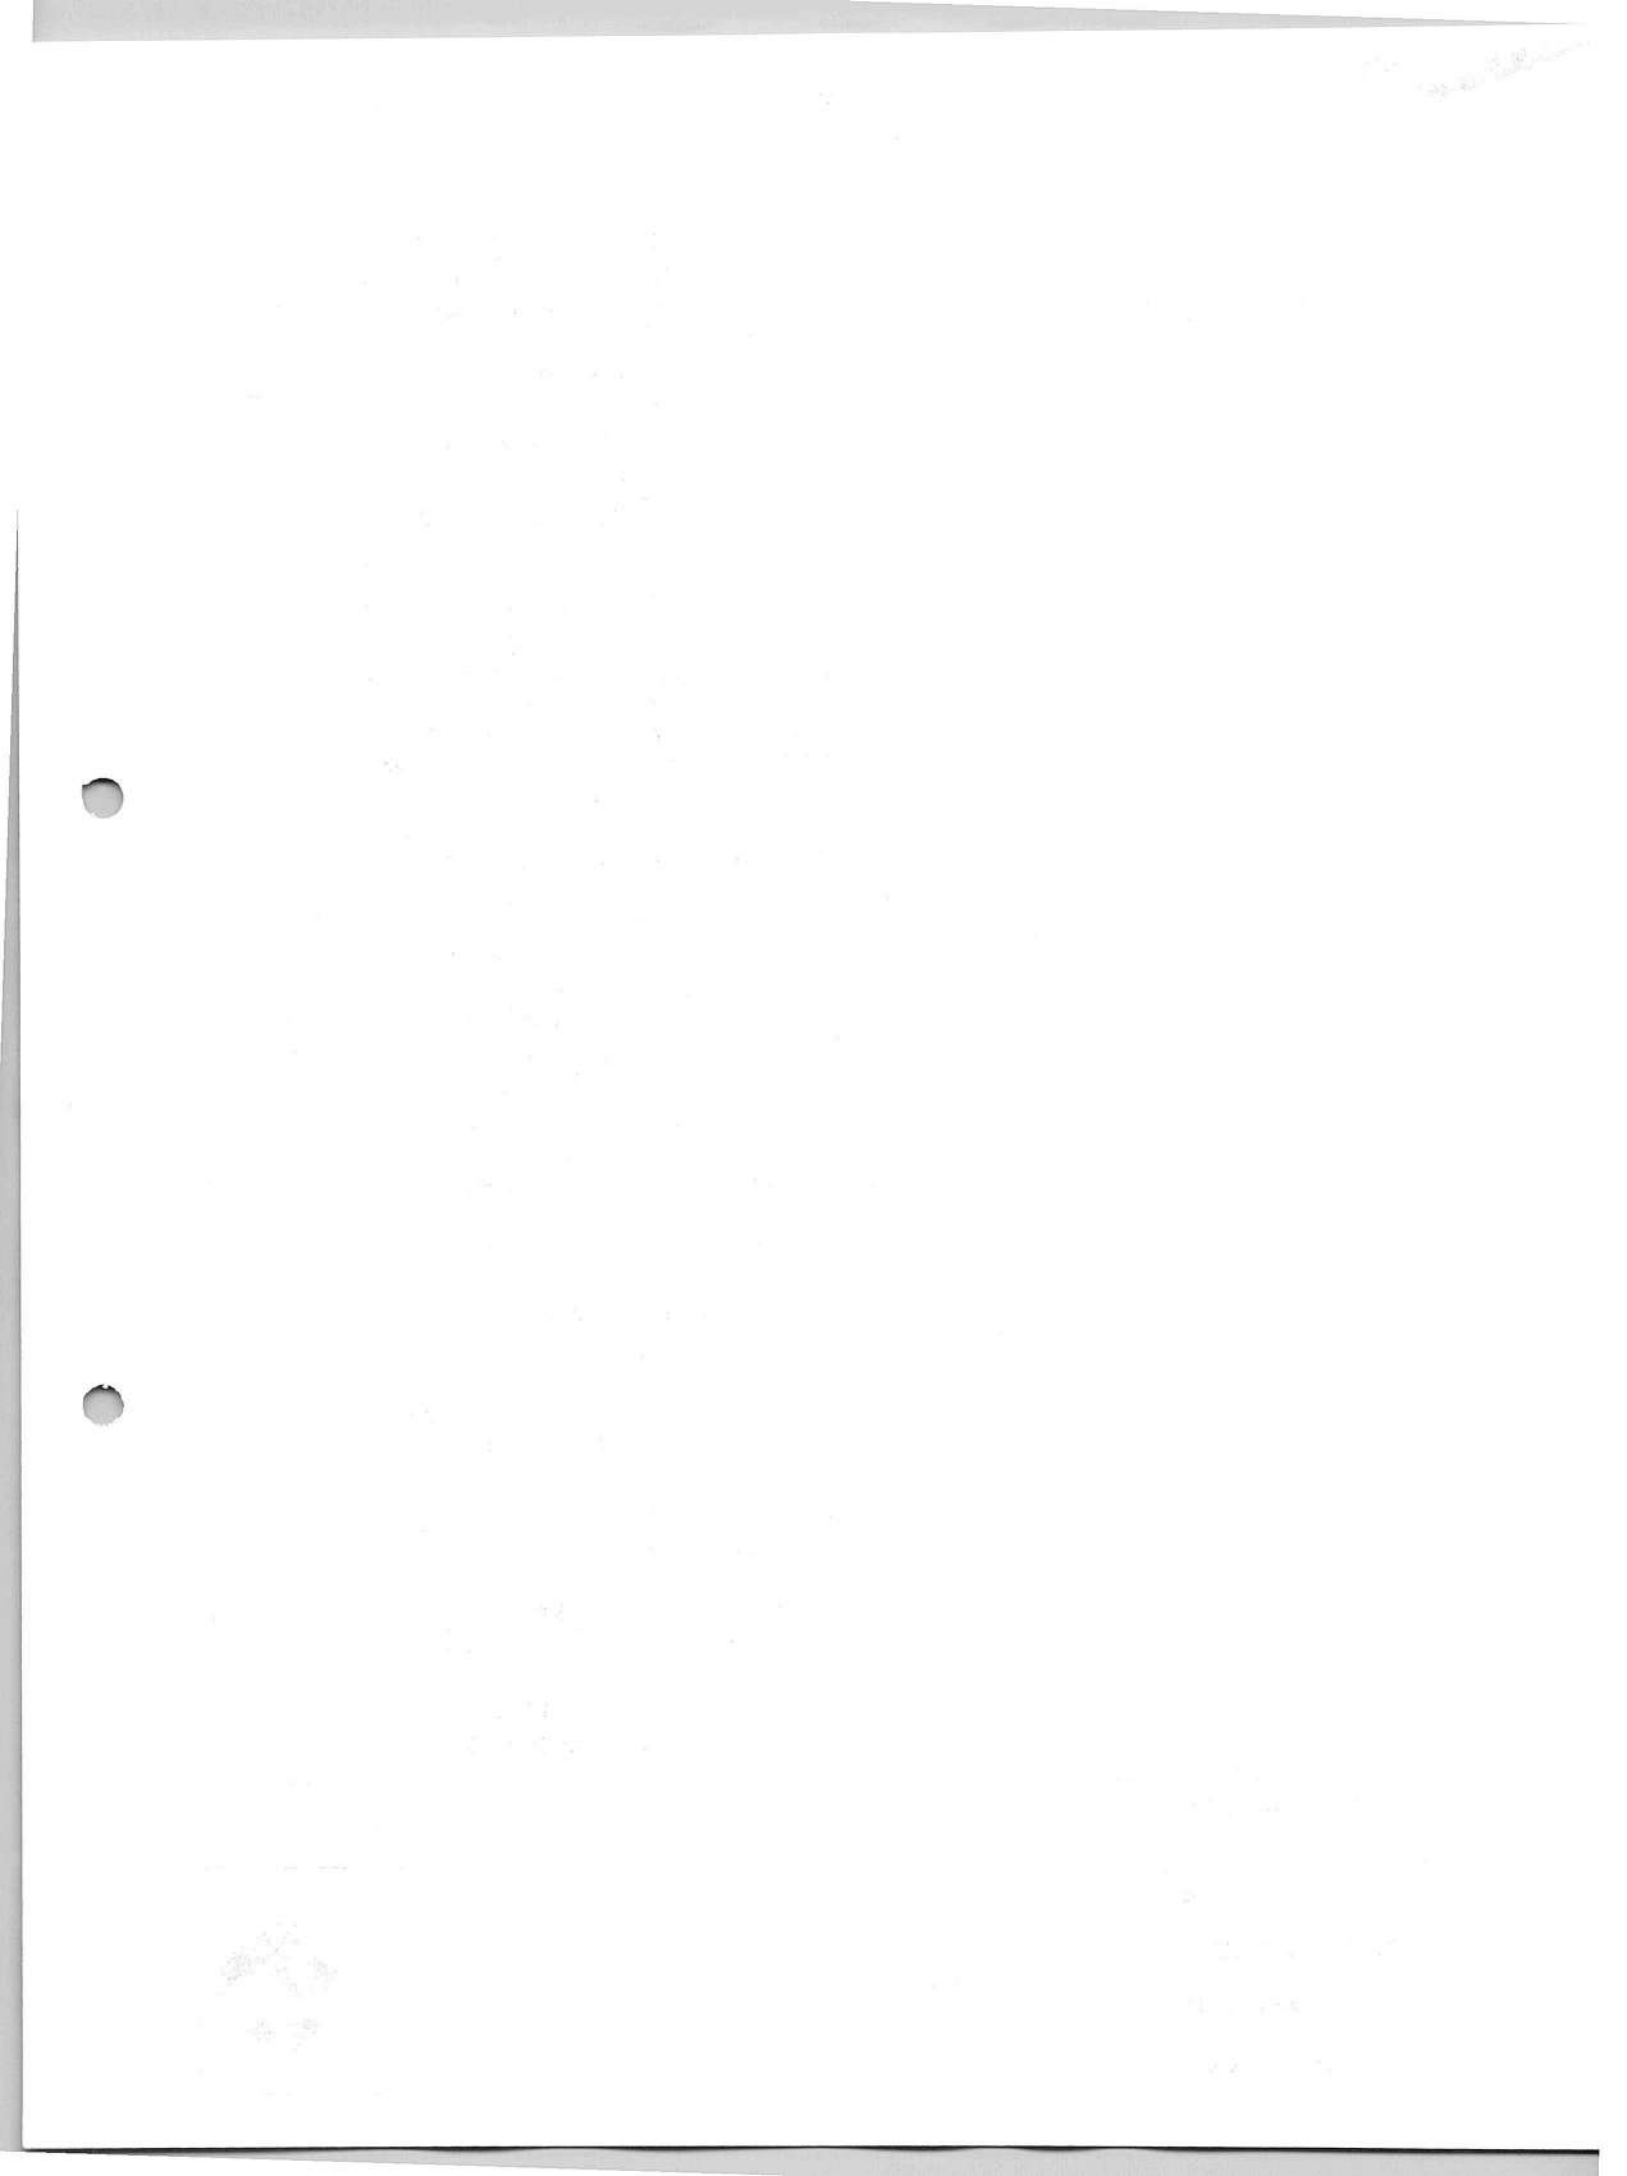

 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	CERTIFICACIÓN	CÓDIGO GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025
		Página: 4 de 4

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION	VALOR PAA 2026 CON IVA INCLUIDO
67	VALVULA EXPIRATORA VELA	UNIDAD	\$ 4.990.296,96
68	TOCO	UNIDAD	\$ 1.941.000,00
69	TRANSDUCTOR	UNIDAD	\$ 1.941.000,00
70	BOMBILLO EQUIPO DE ORGANOS	UNIDAD	\$ 763.221,89
71	SOKET LARINGOSCOPIO	UNIDAD	\$ 909.995,33

Nota: Fuente de información plan anual de adquisiciones 2026 HSVA-E.S.E.

Adicionalmente, la presente certificación es expedida de acuerdo a las cotizaciones presentadas junto al estudio de necesidad proyectado por **ERIKA TATIANA CARRASCAL CARRASCAL**, subdirectora Administrativa, por lo que serán considerados como el valor máximo permitido para realizar la compra de los insumos para el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados en Arauca a los veinte días (20) del mes de febrero del 2026.


SORANGELA CALDERON CASTILLO
 Almacenista General

PROYECTO Y DIGITO: SORANGELA CALDERON CASTILLO

Siempre pensando en tu salud y bienestar